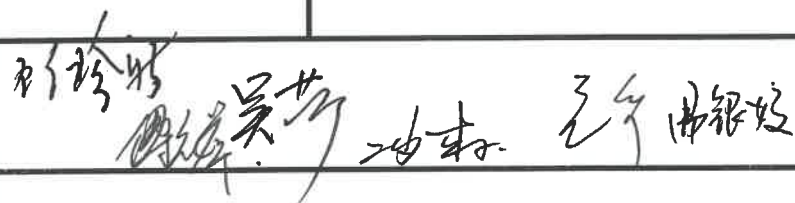


岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称: 平江县梅仙镇中心卫生院 编制时间: 2026.8.14

项目名称		平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目		
采购单位		平江县梅仙镇中心卫生院		
√自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	毛华	18073006570		
	其它参与编制人员			
□委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年9月		
	项目进场/交付时间	2026年10月		
	项目实施地点	平江县梅仙镇中心卫生院		

合同订立安排	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购				
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构				
	供应商资格条件	1、供应商的基本资格条件： (1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 (4) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 包名称：平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目 ☒ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位） 3、供应商特定资格条件： 包名称：平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目 特定资格条件： (1) 供应商须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证），且证书在有效期内； (2) 所投产品须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证），且证书在有效期内。				
	项目预算金额	750000元				
	项目最高限价	750000元				
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
		采购包划分要求	/			
		合同分包要求	/			
标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	

平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目	台	5	国产	血透机	/
	台	1	国产	透析水处理机	

合同订立安排	包装和运输要求	1.1) 供应商负责产品到交货地点的全部运输, 包括装卸及现场搬运等。 1.2) 供应商负责产品在交货地点的保管, 直至项目验收合格。
	保险要求	供应商负责其派出的交货人员的薪水支付和人身意外保险。
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☒ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要
	需要批准的报批安排	/
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请(推荐)方式
	用供应商邀请方式的依据	/
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法
	选最低评标价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法, 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”

	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	最低评标价法:是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
合同管理安排	合同类型	☒ 买卖合同 ☐ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目为货物
	定价方式	☒ 固定总价, 要求:不高于预算金额
		☐ 固定单价, 要求:
		☐ 成本补偿, 要求:
		☐ 绩效激励, 要求:
选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标,需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目,根据实现项目目标的要求,采取固定总价定价方式	
	合同文本的主要条款	一、采购项目名称:平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目 二、供货范围: 项目清单中货物的运输、保险和保管、搬运、安装、调试、培训、免费提供技术服务。 三、交货时间和地点: 交货地点:采购人指定。 交货时间:签订合同之日起30天。 四、质量要求: 产品按国家行业标准执行。验收时必须达到国家和行业的有关规定和标准,由相关职能部门分不同批次按国家标准进行质量检验,若产品经检验质量低于相关标准;则买方可拒付货款。 五、验收 质量要求:合格。 合同款支付方式:合同中约定。

	履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☒ 服务对象 ☐ 其他
合同管理安排	履约验收时间	按合同条款约定执行
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	按合同条款约定执行
	履约验收内容	按合同条款执行
	履约验收验收标准	合格
	履约验收其他事项	按合同条款执行
付款方式		按合同约定

填表说明:

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称：平江县梅仙镇中心卫生院

编制时间：2026.8.14

项目名称		平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目				
采购单位		平江县梅仙镇中心卫生院				
√自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱		
	毛华	18073006570				
	其它参与编制人员	刘玲芳 廖芳 冯志 毛 吕 吕银蛟				
□委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称					
	联系人	联系方式		电子邮箱		
采购项目类别		√货物 □服务 □工程				
需求调查	是否开展需求调查	√是 □否				
	不开展需求调查的理由					
预算金额（如有分包，请自行加行）		750000元				
采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目	台	5	国产	血透机	
		台	1	国产	透析水处理机	

	技术要求	详见附件
技术商务要求 (如有分包, 请自行加行)	商务要求	一、采购项目名称: 平江县梅仙镇中心卫生院血液透析专科建设配套设备采购项目 二、供货范围: 项目清单中货物的运输、保险和保管、搬运、安装、调试、培训、免费提供技术服务。 三、交货时间和地点: 交货地点: 采购人指定。 交货时间: 签订合同之日起²⁰天。 四、质量要求: 产品按国家行业标准执行。验收时必须达到国家和行业的有关规定和标准, 由相关职能部门分不同批次按国家标准进行质量检验, 若产品经检验质量低于相关标准, 则买方可拒付货款。 五、验收 质量要求: 合格。 合同款支付方式: 合同中约定。

填表说明: 1、此表为不需开展需求调查的项目, 如果属要开展需求调查的项目, 还需另外填列《需求调查

2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中: 1) 政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2) 服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3) 工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。

血液透析机参数

一、产品功能及特点：

- 1、 ≥ 15 英寸触摸屏，中/英文操作界面。
- 2、 ≥ 180 度屏幕旋转，满足不同角度的需求。
- 3、显示器与报警灯一体，能实现 360° 全方位声光报警；便于医护人员查看。
- 4、具有显示器托盘，能够自由拆卸无需取装螺钉等紧固件，能够同时放置生理盐水，透析器，透析管路等，便于减少操作空间和耗材的放置取放。
- 5、设备侧面配有盐水支架，盐水支架具有快速调节功能，能够单手按压实现任意高度位置停止后自动锁死定位，无需操作人员手动调整锁紧，方便操作人员操作节省时间。
- 6、透析浓缩液防尘盖——防止外界的灰尘和其他物质的污染。
- 7、满足超纯透析功能，标配透析液过滤器接口，提供同品牌透析液过滤器，可以清除透析液中的细菌、内毒素和不溶性颗粒等，实现对病人的超纯透析治疗。
- 8、设备具有 AB 液盖，并且能够在打开后一定位置悬停，便于 AB 液管的取放。
- 9、设备具有吸液管固定扣置于设备后端，便于消毒液吸液管的放置。
- 10、设备后部具有自带的一体化放置平台，能够放置消毒液，便于消毒液的放置和科室空间的利用。
- 11、设备具有 4 个脚轮，每个脚轮都具有独立的自锁功能，便于临床机器移动和固定更便捷稳定。
- 12、可在“预循环”阶段，选择“省液模式”，浓缩液 0 流量待机。
- 13、具有六类曲线设置：提供超滤曲线 ≥ 8 条、Na 曲线 ≥ 8 条，碳酸氢根、透析液流量、透析液温度、肝素曲线为个体化透析治疗提供更多方案。
- 14、具有透析日志功能，存储 ≥ 200 次治疗数据，方便随时查看。
- 15、管路安装时透析液旁路同步安装，简化透析预冲操作步骤。
- 16、具有四个电导传感器，双重透析液混合系统，保证透析液离子浓度更精准。

- 17、 标配大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超 30 分钟。
- 18、 治疗时，断电后血流量自动下降至 100ml/min，除水路停止外其他系统运行正常。
- 19、 启动紧急键后，血流量自动降至 100ml/min 流速，停止超滤。
- 20、 静脉壶具有液位检测功能，能有效的监控静脉壶的液位更安全。
- 21、 联网功能：可与医院信息系统联网。
- 22、 具有热消毒、化学消毒、化学热消毒。

二、产品参数

- 1、供水压力：0.1MPa~0.5MPa
- 2、供水温度：5℃~30℃
- 3、血泵流量：30ml/min~500ml/min(误差范围±10ml/min 或±10%)
- 4、肝素泵：0~10ml/h
- 5、动脉压力：-700mmHg~+800mmHg（精度为±10mmHg）
- 6、静脉压力：-700mmHg~+800mmHg（精度为±10mmHg）
- 7、跨膜压：-100mmHg~+800mmHg（精度为±10mmHg）
- 8、空气监测：血液管路超声和光电监测，液位电容监测
- 9、透析液流量：300ml/min~800ml/min(允差为-5%~+10%)
- 10、透析液温度：33-40℃（允差为±0.5℃）
- 11、电导率：12.7mS/cm~15.9mS/cm(允差为±0.2mS/cm)
- 12、钠离子调整范围：125-155mmol/L
- 13、碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L
- 14、漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）

透析水处理机技术参数

- 1、进水要求：进水量>4.0T/H，水压>0.2Mpa。
- 2、产水量：一级产水≥2400L/H，二级产水≥1200L/H。
- 3、产水水质：符合 YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》要求，菌落数<100CFU/ml, 内毒素<0.25EU/ml。
- 4、纯水供水方式：直供供水方式，恒定压力范围：0.15~0.3Mpa。
- 5、主要工艺：设备须由原水增压装置 +预处理系统 +双级反渗透系统+ 控制系

统组成。直接将原水制成符合透析用水标准的纯水，设备由控制系统全自动控制整套反渗透系统。

6、原水增压泵：独立变频，采用模拟量压力变送器控制，非传统压力开关控制；全自动加压泵组件，带有低压保护装置，可防止加压泵无水空转。

7、反渗透主机采用高品质低噪音泵，提供足够的后备冗余，保证反渗透主机能够长时间连续运行。整套系统水泵均高品质低噪音泵，提供足够的后备冗余设计。

8、设备有多种保护功能，具备自动检测、自动运行、相关连锁保护功能、低压、高压、电源保护、水质超标等报警功能。

9、设备运行后的定时冲洗及软化再生等保护功能，确保设备运行的稳定与安全，有效避免菌类的滋生。

10、系统配备平衡系统，确保设备因水压及一级反渗透膜正常衰竭而造成水量不足等不稳定因素出现时系统的稳定。

11、系统具有漏水保护功能。

12、具有完备的应急措施，一级反渗透系统与二级反渗透系统也可互为独立工作，实现设备的在线维护，提高设备运行的安全与稳定性。

13、定时开关机功能，每天可根据用户需求设置不同的运行时间。

14、采用一键全自动消毒功能，实时监测并在线显示消毒运行工作状态和时间，可对消毒运行是否完整进行验证，并有声光警示，确保消毒的安全。

15、电气控制系统：严格按照 CE 标准设计，电气柜 IP 防护等级达到 IP4 级。

16、主机控制部分加装缺相及相序保护装置，并安装一键操作开关。

17、控制系统：PLC+触摸屏组合，中文菜单显示，密码保护功能，可方便人机对话，操作系统中有手动、自动、消毒、系统参数 4 个界面，其中自动界面中有双级、单一级、单二级操作界面，工作界面中能显示所有泵体、阀件、液位实时状态。可扩展 IT 连接和远程监控。

18、预处理系统：预处理设置有砂滤器、碳滤器、软化器，预处理罐规格均采用 1865 型。

19、精密过滤器：20 英寸 5 芯 304 不锈钢过滤器，压力等级 $\geq 1.0\text{Mpa}$ 。

20、平衡器：采用亚光 304 不锈钢方型平衡器，不锈钢板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，与主机一体化设计，固定在主机上，采用模拟量液位及智能调节阀控制系统水量平衡，

平衡器液位数值显示于触摸屏上精度达到厘米。

21、反渗透膜：一级反渗透膜尺寸数量：8040×2；二级反渗透膜尺寸数量：8040×1，总计3支。

22、膜压力容器：卫生级 304 以上不锈钢材质，压力等级 $\geq 3.5\text{Mpa}$ ，采用环绕式固定方式，进出口采用快装接头连接方式，安全可靠，维护方便。

23、主机管道：采用卫生级 304 以上不锈钢材质，焊接工艺采用氩气保护及自动焊机环缝焊接一次成型，管道内壁光滑平整。管道连接采用内置硅胶垫圈的卡箍式快装。管道压力等级 $\geq 2.5\text{Mpa}$ 。

24、循环管路：采用卫生级管路，管网末端设置有高品质恒压阀，实现供水压力稳定。

25、主机机架：表面拉丝处理，方管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，304 不锈钢方管焊接成型，整台机架通过力学平衡设计，底盘采用医用万向轮及金属底脚，方便移动和固定。

26、控制阀门：均采用卫生级 304 不锈钢阀门，线性调节流量及压力，电动阀均采用优质品牌，性能稳定。